

总抗坏血酸（TAA）含量测定试剂盒说明书

（货号：ADS-W-VC008-96 微板法 96 样）

一、产品简介：

总抗坏血酸（TAA）包括还原型和脱氢型抗坏血酸，其中还原型抗坏血酸易被氧化为脱氢型抗坏血酸，后者与 2, 4-二硝基苯肼作用生成可溶于硫酸的红色脎，该红色物质在 520nm 下有最大吸收峰，进而计算得到总抗坏血酸（TAA）含量。

二、试剂盒的组成和配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 110mL×1 瓶	4℃ 保存	
试剂一	粉剂 1 瓶	4℃ 保存	用前甩几下或 4℃ 离心使试剂落入试管底部，再加入 15ml 的 25%硫酸，混匀，4℃ 保存。
标准品	粉剂 1 支	4℃ 保存	若重新做标曲，则用到该试剂。

三、所需的仪器和用品：

酶标仪、96 孔板、浓硫酸、研钵冰、低温离心机、可调式移液器和蒸馏水。

四、总抗坏血酸（TAA）含量测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备：

① 组织样本：

称取约 0.3g 组织(水分充足的样本取约 0.5g 组织)，加入 1mL 提取液，进行冰浴匀浆。12000rpm, 4℃ 离心 10min，取上清，置冰上待测。

【注】：若增加样本，可按照组织质量（g）：提取液体积(mL)为 1：5~10 的比例进行提取

② 液体样本：直接检测。若浑浊，离心后取上清检测。

2、上机检测：


① 酶标仪预热 30 min，调节波长到 520 nm。

② 依次在 96 孔板中或 EP 管中依次加入：

试剂名称（μL）	测定管	对照管
样本	20	20
试剂一	60	
38℃（恒温培养箱，若用 96 孔板，则需用板子或保鲜膜遮盖，防止水分蒸发），孵育 3 小时		
试剂一		60
85%硫酸 (务必在冰上缓慢加入)	140	140
混匀，室温 25℃静置 20min（准确时间）。液体全部转移至 96 孔板中，于 520nm 处分别读取 A 值， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ （每个测定管需要一个对照管）		

五、结果计算：

1、标准曲线方程： $y = 0.0611x + 0.0003$ ，x 是标准品 VC 质量（μg），y 是 ΔA 。

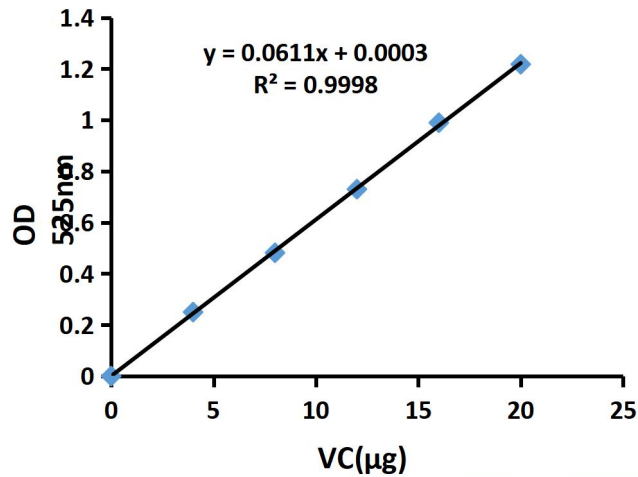

2、按蛋白浓度计算

$$\text{TAA}(\mu\text{g}/\text{mg prot}) = [(\Delta A - 0.0003) \div 0.0611] \div (\text{Cpr} \times V1) \times D = 818 \times (\Delta A - 0.0003) \div \text{Cpr} \times D$$

3、按样本质量计算

$$\text{TAA}(\mu\text{g}/\text{g 鲜重}) = [(\Delta A - 0.0003) \div 0.0611] \div (W \times V1 \div V) \times D = 818 \times (\Delta A - 0.0003) \div W \times D$$

4、按液体体积计算

$$\text{TAA}(\mu\text{g}/\text{mL}) = [(\Delta A - 0.0003) \div 0.0611] \div V1 \times D = 818 \times (\Delta A - 0.0003) \times D$$

V----加入提取液体积，1 mL；

V1----加入反应体系中上清液体积，0.02mL；

Cpr----上清液蛋白质浓度，mg/mL；建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

W----样品质量 (g)；

D----稀释倍数，若没有稀释即为 1。

附：标准曲线制作过程：

- 1 制备标准品母液 (1mg/mL)：向标准品中加入 1mL 蒸馏水，充分溶解，(母液需在两天内用且 -20℃ 保存)。
- 2 把母液稀释成六个浓度梯度的标准品：0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. mg/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 依据测定管的加样体系操作，根据结果即可制作标准曲线。